Mode d'emploi - Modo de empleo

1- Caractéristiques:
Rang: ORP: de 0~ ± 1999 mV
résolution: 1mV
Précision : ± 5mV
Piles: 4 x 1,5v (AG-13button cell)
Temperature de fonctionnement: 0°C~50°C
Dimensions : (Longueur x largeur x hauteur) 170 x 36 x 23 mm
Poids : 96g

2- Fonctionnement
1- Enlever le couvercle
2- Mettre le bouton du haut du couvercle sur «ON »
3- Mettre l'electrode dans l'eau jusqu'au niveau indiqué. NE JAMAIS mettre l'écran du tester sous aucun concept sous l'eau.
4- Maintenir sous l'eau le tester durant +/- 2 minutes puis lire les données affichées sur l'écran.
5- Une fois utilisé, Eteindre en mettant le bouton du haut du couvercle sur « OFF ». Utiliser de l'eau distillée pour nettoyer l'électrode et remettre le bouchon protecteur.

3- Calibrer le testeur
1-Mettre l'electrode dans de l'eau distillée et allumer le testeur après quelques heures.
2- Mettre le testeur dans une solution standard et l'agiter doucement.
3- Régler à l'aide du tournevis sur la valeur 265mV
4- Nettoyer l'electrode dans de l'eau distillée et la nettoyer avec du papier-filtre.

IMPORTANT :
L'ensemble des instruments de mesure doivent être régulièrement recalibrés.
Approximitativement tous les mois, il faut récalibrer l'appareil.
Si l'electrode a été utilisé dans des conditions particulières.
La plus grande précision est réquise.

4- Installation des piles :
Si le testeur ne fonctionne pas en le mettant en position « ON » ou si l'écran perd de l'intensité, il faut changer les piles. Pour cela, ouvrir enlever les piles du compartiment situé sous le couvercle haut du testeur et remplacer les piles. Faire attention à la polarité des piles.

5- Garantie :
Le testeur est garanti pour tous défauts dûs au matériel et sa production pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat.
Si durant cette période, il faut effectuer une réparation ou le remplacement de différents éléments, et quand ceci ne soit pas dû au mauvais usage ou la négligence de l'utilisateur.Veuillez retourner ces éléments au vendeur et la réparation sera effectuée gratuitement.

1- Caracteristicas:
Rango: ORP: de 0~ ± 1999 mV
Resolución: 1mV
Precisión : ± 5mV
Pilas: 4 x 1,5v (AG-13button cell)
Temperatura de funcionamiento: 0°C~50°C
Dimensiones : (Largo x ancho x alto) 170 x 36 x 23 mm
Peso : 96g

2- Funcionamiento
1- Quitar la tapa
2- Poner en marcha con el botón "ON" de la parte alta del comparador
3- Poner el electrodo en el agua hasta el nivel indicado. No PONER BAJO NINGÚN CONCEPTO la pantalla bajo del nivel del agua
4 - Maneter bajo el agua el comparador durante +/- 2 minutos. Luego leer los datos en la pantalla.
5- Una vez utilizado, Apagarlo pulsando el boton "OFF". Utilizar de nuevo agua distilada para limpiar el electrodo y poner de nuevo la tapa protectora.

3- Calibrar el comparador
1- Poner el electrodo en agua distilada y encender el comparador unas horas después.
2- Poner el comparador en una solución estandar y agitarlo suavemente.
3- Ajustar los datos con el destornillador para obtener el valor 265mV.
4- Limpiar el electrodo con agua distilada y limpiarlo con papel filtrante.

IMPORTANTE :
Todos los instrumentos de medición deben ser calibrados regularmente.
Hace falta calibrar el comparador cada mes aproximadamente si el electrodo ha sido utilizado en condiciones especiales.
Una gran precisión es requerida.

4- Instalación de las pilas :
Si el comparador no funciona en posición « ON » o si la pantalla pierde intensidad, se necesita cambiar las pilas. Para hacerlo, abrir y quitar las pilas del compartimento situado debajo de la parte alta del comparador y cambiar las pilas. Tener cuidado con la polaridad de las pilas.

5- Garantía :
El comparador tiene garantía de cara a todos los defectos debidos al material y su producción para un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Si durante ese periodo, durante ese periodo se necesita hacer una reparación o cambiar los elementos defectuosos que no sean debidos al desgaste, negligencia o mal uso por parte del consumidor, por favor, mandar el comparador con todos sus componentes a la tienda donde lo habéis comprado, la reparación se efectuara de forma gratuita.

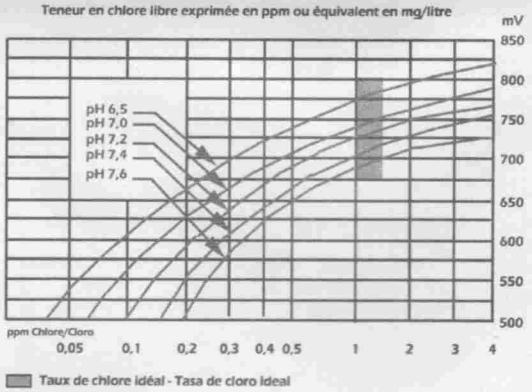

FR:
1- Vérifier votre pH à l'aide du testeur digital de pH, celui-ci doit être compris entre 7,2 et 7,6. Ajustez-le si nécessaire.
2- Afin d'obtener un degré de desinfection nécessaire, le niveau ORP de lecture du testeur doit être compris entre 650 et 800mV pour les traitements au chlore, brome ou Oxygène Actif. Vous trouverez à votre gauche le tableau d'équivalence du chlore pour exemple.

ES:
1- Controlar el nivel de pH del agua con el comparador digital de pH, éste debe estar entre 7, 2 y 7,6. Ajustarlo si necesario.
2- Para obtener el nivel de desinfección necesario de su agua, el nivel ORP que mide su comparador debe estar entre 650 y 800mV para los tratamientos con Cloro, Bromo u Oxigeno Activo. Encontrareis a su izquierda la tabla de equivalencia del cloro como ejemplo.